

Số: 77 /TM-BV

Vũ Thư, ngày 11 tháng 5 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các nhà cung cấp thiết bị, vật tư điện nước tại Việt Nam**

Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “ mua sắm thiết bị, vật tư điện nước của Bệnh viện đa khoa Vũ Thư” với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.**

- 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư.
- 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  
Đ/c: Hà Văn Dương  
Chức vụ: Cán bộ phòng HCTC - SĐT: 0965.073.024  
Email: [anh.bvdkvt@gmail.com](mailto:anh.bvdkvt@gmail.com).
- 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn Thư Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư, Địa chỉ: xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên;
  - Qua đường chuyển phát tại địa chỉ: Phòng Văn Thư Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư, Địa chỉ: xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên;  
SĐT: 0227.3826.306
- 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 12 tháng 5 năm 2026 đến trước 16h30 phút ngày 18 tháng 5 năm 2026.  
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2026.

**Lưu ý:** Báo giá phải được người có thẩm quyền ký trực tiếp trên văn bản giấy, khi ký văn bản dùng bút có mực xanh, không dùng các loại mực dễ phai hoặc dùng dấu chữ ký khắc sẵn để ký báo giá


**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

| STT | Danh mục tài sản, hàng hoá                            | ĐVT | Số lượng | Thông số kỹ thuật( nếu có) |
|-----|-------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------|
| 1   | Cáp điện 0.6/1KV – Cu/XLPE/PVC 1 x 300mm <sup>2</sup> | Mét | 165      | Theo thông số nhà sản xuất |
| 2   | Cáp CXV – Cu/XLPE/PVC 1 x 240                         | Mét | 72       | Theo thông số nhà sản xuất |
| 3   | Dây điện mềm Cu/PVC 1 x 95                            | Mét | 15       | Theo thông số nhà sản xuất |
| 4   | Cáp Cu/XLPE/DSTA/PVC 3x25 + 1x16                      | Mét | 75       | Theo thông số nhà sản xuất |

|    |                                  |     |     |                            |
|----|----------------------------------|-----|-----|----------------------------|
| 5  | Cáp Cu/XLPE/DSTA/PVC 3x35 + 1x16 | Mét | 46  | Theo thông số nhà sản xuất |
| 6  | Dây cáp 3 x 16 + 1x10            | Mét | 55  | Theo thông số nhà sản xuất |
| 7  | Đầu cos M300                     | Cái | 20  | Theo thông số nhà sản xuất |
| 8  | Đầu cos M240                     | Cái | 8   | Theo thông số nhà sản xuất |
| 9  | Át 600A 3P                       | Cái | 1   | Theo thông số nhà sản xuất |
| 10 | Ống nhựa HDPE DN50 PN10          | Mét | 200 | Theo thông số nhà sản xuất |
| 11 | Đầu cốt đồng M35 - 16            | Cái | 20  | Theo thông số nhà sản xuất |

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Website bệnh viện ĐK Vũ Thư;
- Lưu: VT.

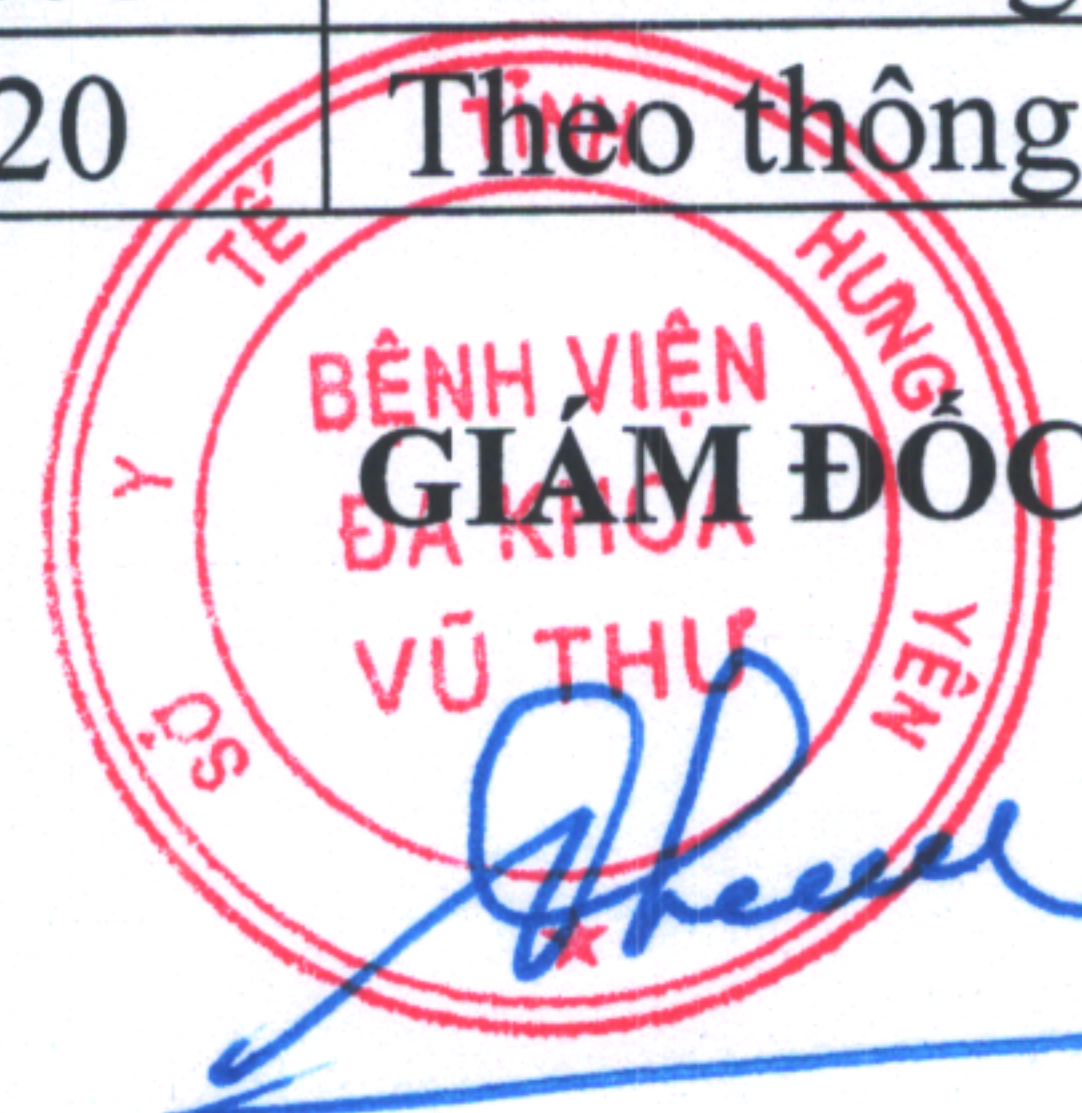

**Đỗ Văn Lương**

